


GUIDE RAPIDE D'UTILISATION



Allumer et programmer l'analyseur.



Avant ouverture des tubes, s'assurer que les liquides ou lyophilisats qu'ils contiennent sont bien au fond des tubes.

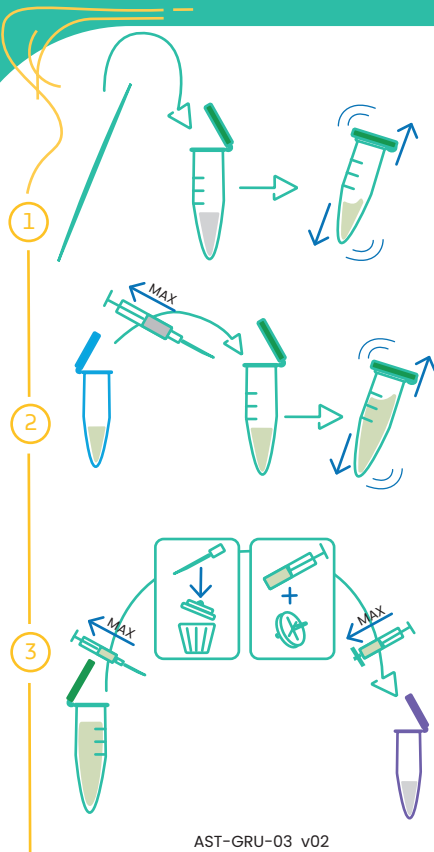

Prélever l'équivalent d'un demi grain de semoule de fèces à l'aide du **pic** fourni puis immerger et faire tourner le **pic** dans le **tube vert**.

Agiter vigoureusement le **tube vert**.


Transférer l'intégralité du **tube bleu** avec la même **seringue** munie de l'**aiguille** dans le **tube vert** puis agiter vigoureusement.

Prélever le maximum de liquide du **tube vert** avec la même seringue munie de l'**aiguille**.

Jeter l'**aiguille** et munir la **seringue** d'un **filtre**.

Positionner le **filtre** dans le **tube violet** et appuyer sur le piston de la **seringue** jusqu'à obtenir un maximum de liquide.


4

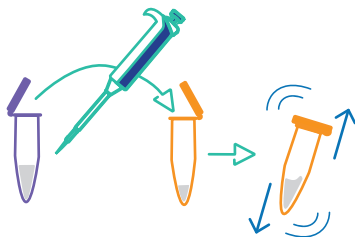

Prélever un volume du **tube violet** à l'aide de la **pipette bleue** munie d'un cône à filtre.


Déposer ce volume dans le **tube orange** puis agiter vigoureusement.

5

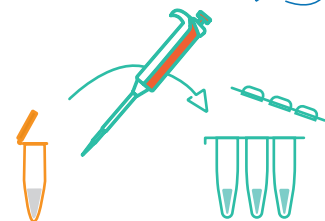

Déposer un volume du **tube orange** dans chaque **minitube** à l'aide de la **pipette orange** munie d'un cône à filtre.

6

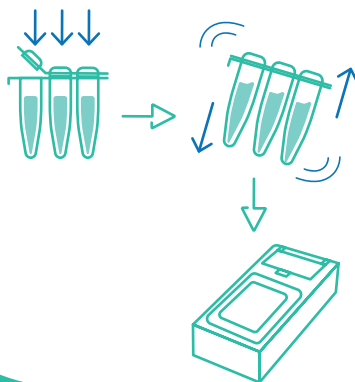

Bien fermer les **minitubes** puis agiter et faire redescendre toutes les gouttelettes au fond des tubes.

Insérer les **minitubes** dans l'analyseur (en plaçant le détrompeur à gauche) puis refermer immédiatement le capot de l'analyseur pour lancer l'analyse.



Ne jamais réouvrir les minitubes une fois la réaction démarrée, ni après la fin de celle-ci. Ne pas laisser les minitubes dans l'analyseur une fois la réaction terminée.

Se référer au manuel d'utilisation pour des informations plus détaillées :

Contact : +33 (0)1 73 21 78 21 • service_client@enalees.com



bit.ly/manuel-fr-enalees